Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР	ТЕЛЕЖКИ ЭЛЕКТРОВЕСОВЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ Т132Т3,2	Внесены в Государственный реестр под № 3804—73

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тележки электровесовые платформенные Т132Т3,2 (см. рисунок) предназначены для взвешивания и транспортирования компонентов шихтовых и других материалов в литейных цехах металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий.

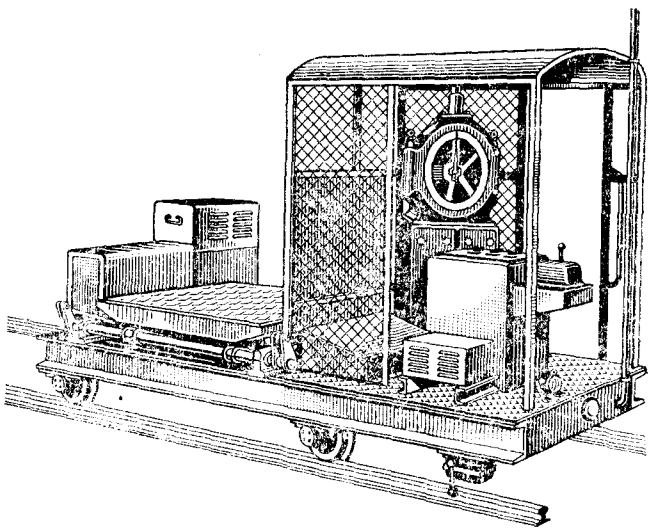

ОПИСАНИЕ

Масса взвешиваемого груза, находящегося на грузоприемной платформе, через весовой механизм — рычажный редуктор с передаточным отношением 1:25,6 — передается на тягу

Утверждены Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 23/X 1973 г.	Выпуск разрешен до 1/I 1979 г.

Из Выпуска 33 1974 г.

указательного прибора — пружинного силоизмерителя с круговой шкалой (УЦК 600/320-125-10 ГОСТ 11606—71). Отсчет выполняют визуально по отклонению указательной стрелки. Для предохранения весового механизма указательного прибора имеется механизм изолира, управляемый при помощи гидроустановки. На основной раме смонтирован механизм передвижения тележки.,

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы взвешивания от 160 до 3200 кг.
Цена деления шкалы циферблата 10 кг.
Допускаемая погрешность взвешивания 10 кг.
Скорость передвижения 60 м/мин.
Ширина железнодорожной колеи 1524 мм.
Максимальная длина переезда 50 м.
Питание от сети трехфазного переменного тока напряжением $380^{+10\%}_{-15\%}$, частотой 50±1 Гц.
Габаритные размеры 1600×2100 мм.
Масса 3718 кг.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с тележкой поставляют:
1) комплект запасных частей;
2) техническую документацию;
3) паспорт;
4) руководство по уходу и эксплуатации;
5) ведомость эксплуатационных документов;
6) чертежи и схемы согласно ведомости эксплуатационных документов;
7) ведомость запасных частей;
8) ведомость упаковки.

ПОВЕРКА

Тележку поверяют в соответствии с методикой, указанной в документации, входящей в комплект поставки.

Испытания проводила Одесская межобластная лаборатория государственного надзора за стандартами и измерительной техникой. Результаты испытаний рассматривал Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).

Изготовитель — Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР.